

# フルティフォーム®を お使いになる患者さんへ

## 初めて噴霧する場合

初めて噴霧する場合、または3日以上使用していない場合は、右の操作を行ってから①の手順に進んでください。

吸入器をよく振った後、体から離してアルミ缶を押し、**4回空噴霧**します。

**4回  
空噴霧**



## 赤になったら再受診

カウンターが完全に赤色になったら、残りは約20吸入分です。なるべく早めに受診して、新しいフルティフォームを準備するようにしましょう。



フルティフォームは添加物として無水エタノールを使用しています。  
アルコールに過敏な方は医師・薬剤師に相談してください。

※詳しい吸入器の操作方法は、お薬に添付されている「フルティフォームを使用される患者の皆様へ」をご覧ください。

## 正しい方法で吸入するために、以下のポイントをチェック!

### 1 キャップの左右 を持って外し、

吸入器の底に親指をあて、アルミ缶を人差し指と中指で支え、吸入器をよく振ります。



カウンターの色を確認しましょう。

### 2

吸入器をくわえる前に、軽く息を吐いてください。



### 3 吸入口を軽く歯でくわえ、息を吸いながら

アルミ缶を押し、お薬をゆっくり深く吸い込みます。

シュッと薬剤が出るまでしっかり押ししてください。



### 4

お薬を吸い込んだ後は、吸入口を口から離し、そのまま3秒以上、息を止めてください。



### 5 ゆっくり息を吐き出します。医師に指示された回数、①～⑤

を繰り返します。吸入が終わったら、キャップをつけて保管してください。



### 6

吸入後には、必ずうがいをしてください。



## きちんと吸入できているのかな？

通常は、吸った感じがなくても正しい手順で吸入すれば、きちんと吸入できます。ただし、次のような場合には要注意！

吸入しているときに、吸入器の上部や自分の口の辺りに「噴霧」が見える場合、お薬をうまく吸入していない可能性があります。


その場合、正しい方法で吸入するためのポイントをチェックし、再度吸入してください。



## カウンターが赤色になったら、受診して新しいお薬の準備を！

カウンターの背景の色が赤くなったら、新しいフルティフォームを準備する目安です。

- アルミ缶を押すと、自動的にカウンターが動き、最初は緑色、使っていくうちに黄色、赤色へと変わっていきます。
- カウンターが完全に赤色になったら、残りは約20吸入分です。なるべく早めに受診して、新しいフルティフォームを準備するようにしましょう。
- カウンターの数字は以下のように表示されます。

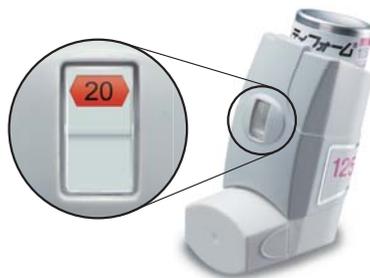

120吸入用

120・110・100・90・80・70・60・55・50・45・40・35・30・25・20・15・10・5・0

56吸入用

56・45・35・30・25・20・15・10・5・0

**注意！** カウンターが「0」になったら、吸入しないでください。「0」になってもアルミ缶を押すことはできますが、十分な量のお薬を吸入することはできません。

「フルティフォーム®の使い方」の動画をwebサイトでご覧いただけます。

<http://www.f-kyunyu.jp/>

● 視聴により発生する通信料は視聴者さまのご負担となります。



キョーリン製薬

改訂年月: 2016.2  
ICFF0006